


Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CS 100-3P2

Capteur de pesage/de force « S » en inox

FRANÇAIS

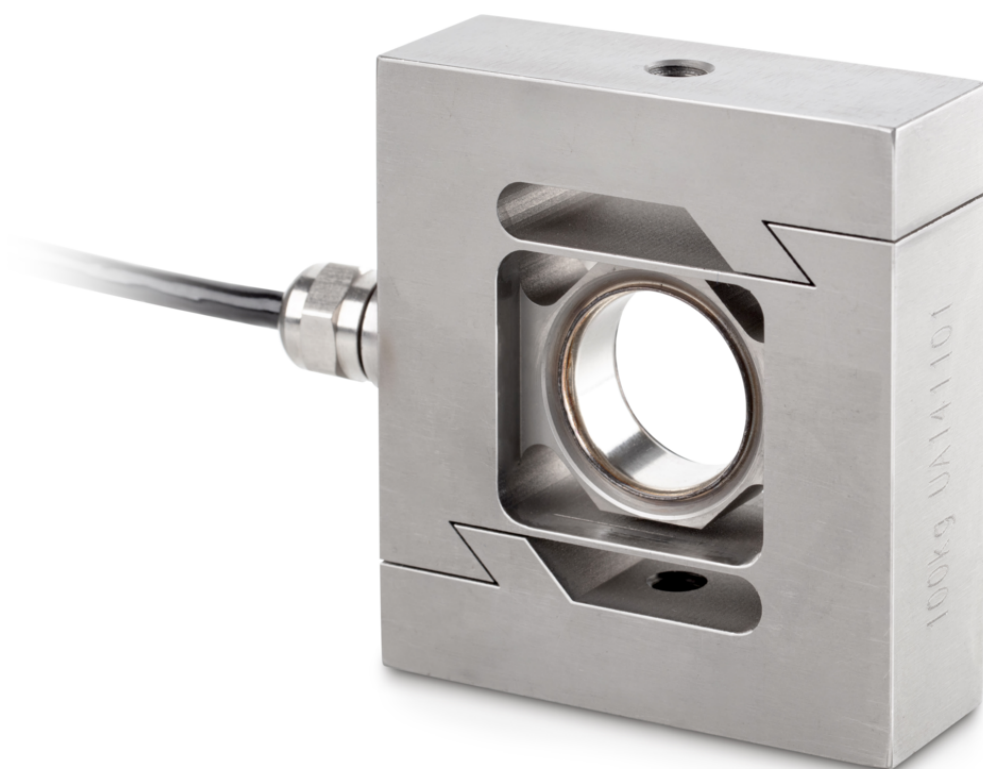

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux balances silo, aux bancs d'essai de force et à diverses autres balances

PICTOGRAMMES

De série

Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plaque de mesure [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE RR8	Extrémité de la tige CE RR8
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65

Modèle	Description
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
FS 403	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 2 kN FS 403
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ
YKV-01	Transmetteur de pesage numérique YKV-01
YKV-02	Transmetteur de pesage numérique YKV-02

SERVICES

Modèle	Description
963-162	Certificat d'étalonnage DAkS 963-162 (direction de force traction unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-162IV	Certificat d'étalonnage DAkS 963-162IV (direction de force traction unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-162V	Certificat d'étalonnage DAkS 963-162V (direction de force traction unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-262	Certificat d'étalonnage DAkS 963-262 (direction de force compression unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-262IV	Certificat d'étalonnage DAkS 963-262IV (direction de force compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-262V	Certificat d'étalonnage DAkS 963-262V (direction de force compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-362	Certificat d'étalonnage DAkS 963-362 (direction de force traction, compression unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-362IV	Certificat d'étalonnage DAkS 963-362IV (direction de force traction, compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-362V	Certificat d'étalonnage DAkS 963-362V (direction de force traction, compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
970-016	Extension de garantie (+3 ans) 970-016

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables