


Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CO 10-Y3

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable


FRANÇAIS

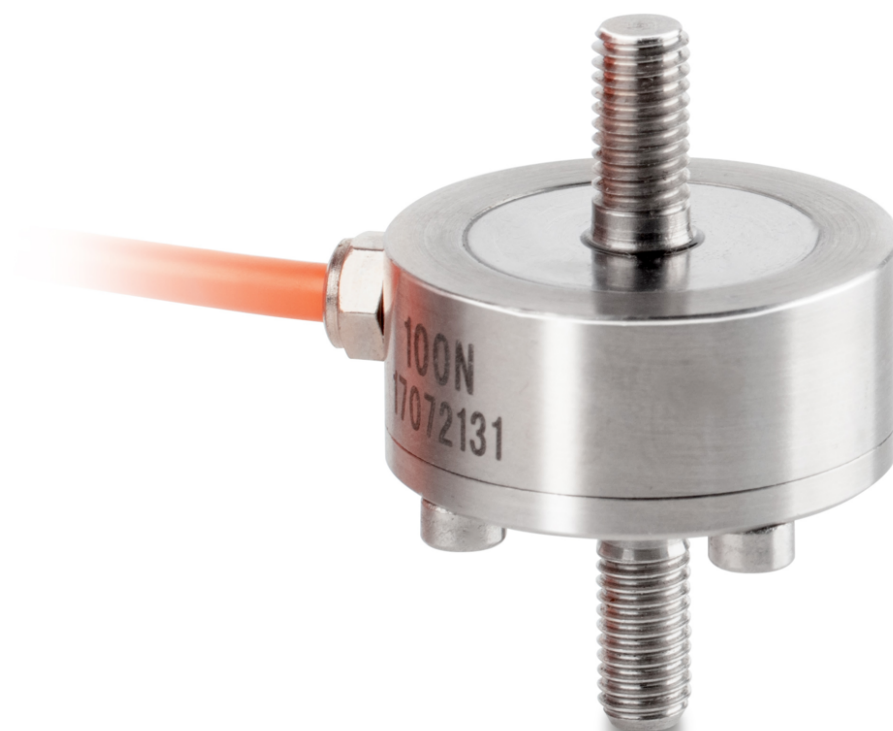


CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



EXEMPLE D'APPLICATION

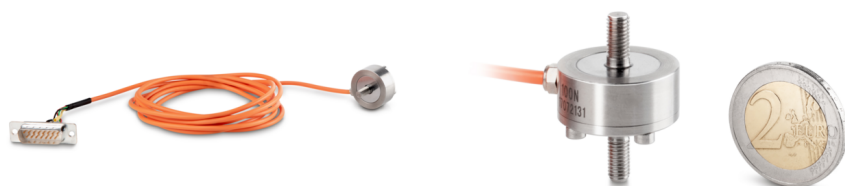

CARACTÉRISTIQUES

- Haute précision (erreur combinée 0,1% F.S.)
- Domaine d'application : applications de traction et de pression, mesures de la masse et de la force
- Convient aux mesure du poids et de force et des bancs d'essai de force

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche et développement
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Industrie automobile et équipementière
- Technique médicale et biomécanique
- Matériel d'étalonnage et construction d'instruments de contrôle

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plague de mesure [Max]
CO 10-Y3	10 kg	100 N

ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 01	Adaptateur AFM 01 (Trou fileté M5 Filetage mâle M6)
AFM 04	Adaptateur AFM 04 (Filetage mâle M10 Trou fileté M5)
FS 402	Connecteur pour cellule de mesure FS monté & ajusté jusqu'à 500 N FS 402
FS TKZ	Affaire de transport FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
961-161	Certificat d'étalonnage usine 961-161 (traction N)
961-261	Certificat d'étalonnage usine 961-261 (compression N)
961-361	Certificat d'étalonnage usine 961-361 (traction, compression N)
963-161	Certificat d'étalonnage DAkS 963-161 (direction de force traction unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-161IV	Certificat d'étalonnage DAkS 963-161IV (direction de force traction unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-161V	Certificat d'étalonnage DAkS 963-161V (direction de force traction unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-261	Certificat d'étalonnage DAkS 963-261 (direction de force compression unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-261IV	Certificat d'étalonnage DAkS 963-261IV (direction de force compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-261V	Certificat d'étalonnage DAkS 963-261V (direction de force compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-361	Certificat d'étalonnage DAkS 963-361 (direction de force traction, compression unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
963-361IV	Certificat d'étalonnage DAkS 963-361IV (direction de force traction, compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage ISO 376)
963-361V	Certificat d'étalonnage DAkS 963-361V (direction de force traction, compression unité résultat de mesure mV/V procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
965-411	Assemblage des composants 965-411 (< 50kg)
970-016	Extension de garantie (+3 ans) 970-016

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP66



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables